



色谱柱选择参考

选择参考

具有代表性的色谱柱种类

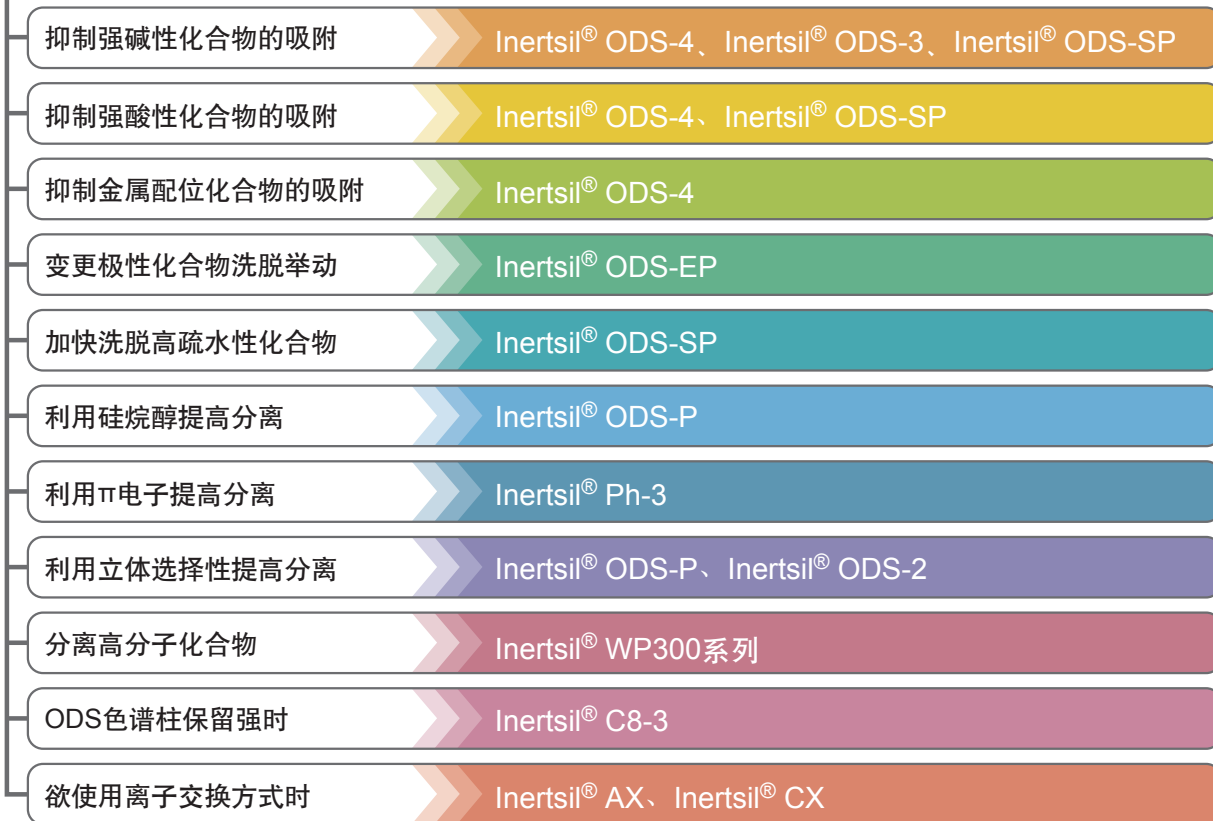

各维生素	性质	HPLC ◎表示经常采用 HPLC 法	色谱柱	检测 (FL) 为基于柱后衍生法的检测
维生素 C	水溶性	◎	NH2,SIL	UV
维生素 B1	水溶性	◎	ODS	UV (FL)
维生素 B2	水溶性	◎	ODS	UV FL
维生素 B6	水溶性	○	ODS	UV
尼亚新	水溶性	○	ODS	UV
叶酸	水溶性	○	ODS	UV
泛酸	水溶性	○	ODS	UV
维生素 A	脂溶性	◎	ODS	UV FL
维生素 D	脂溶性	◎	ODS,NH2	UV
维生素 E	脂溶性	◎	NH2	UV FL
维生素 K	脂溶性	◎	ODS	UV (FL)

固相萃取·前处理附件

通用色谱消耗品


液相色谱消耗品及相关装置

气相色谱消耗品及相关装置

光谱

其他

具有代表性色谱柱的种类

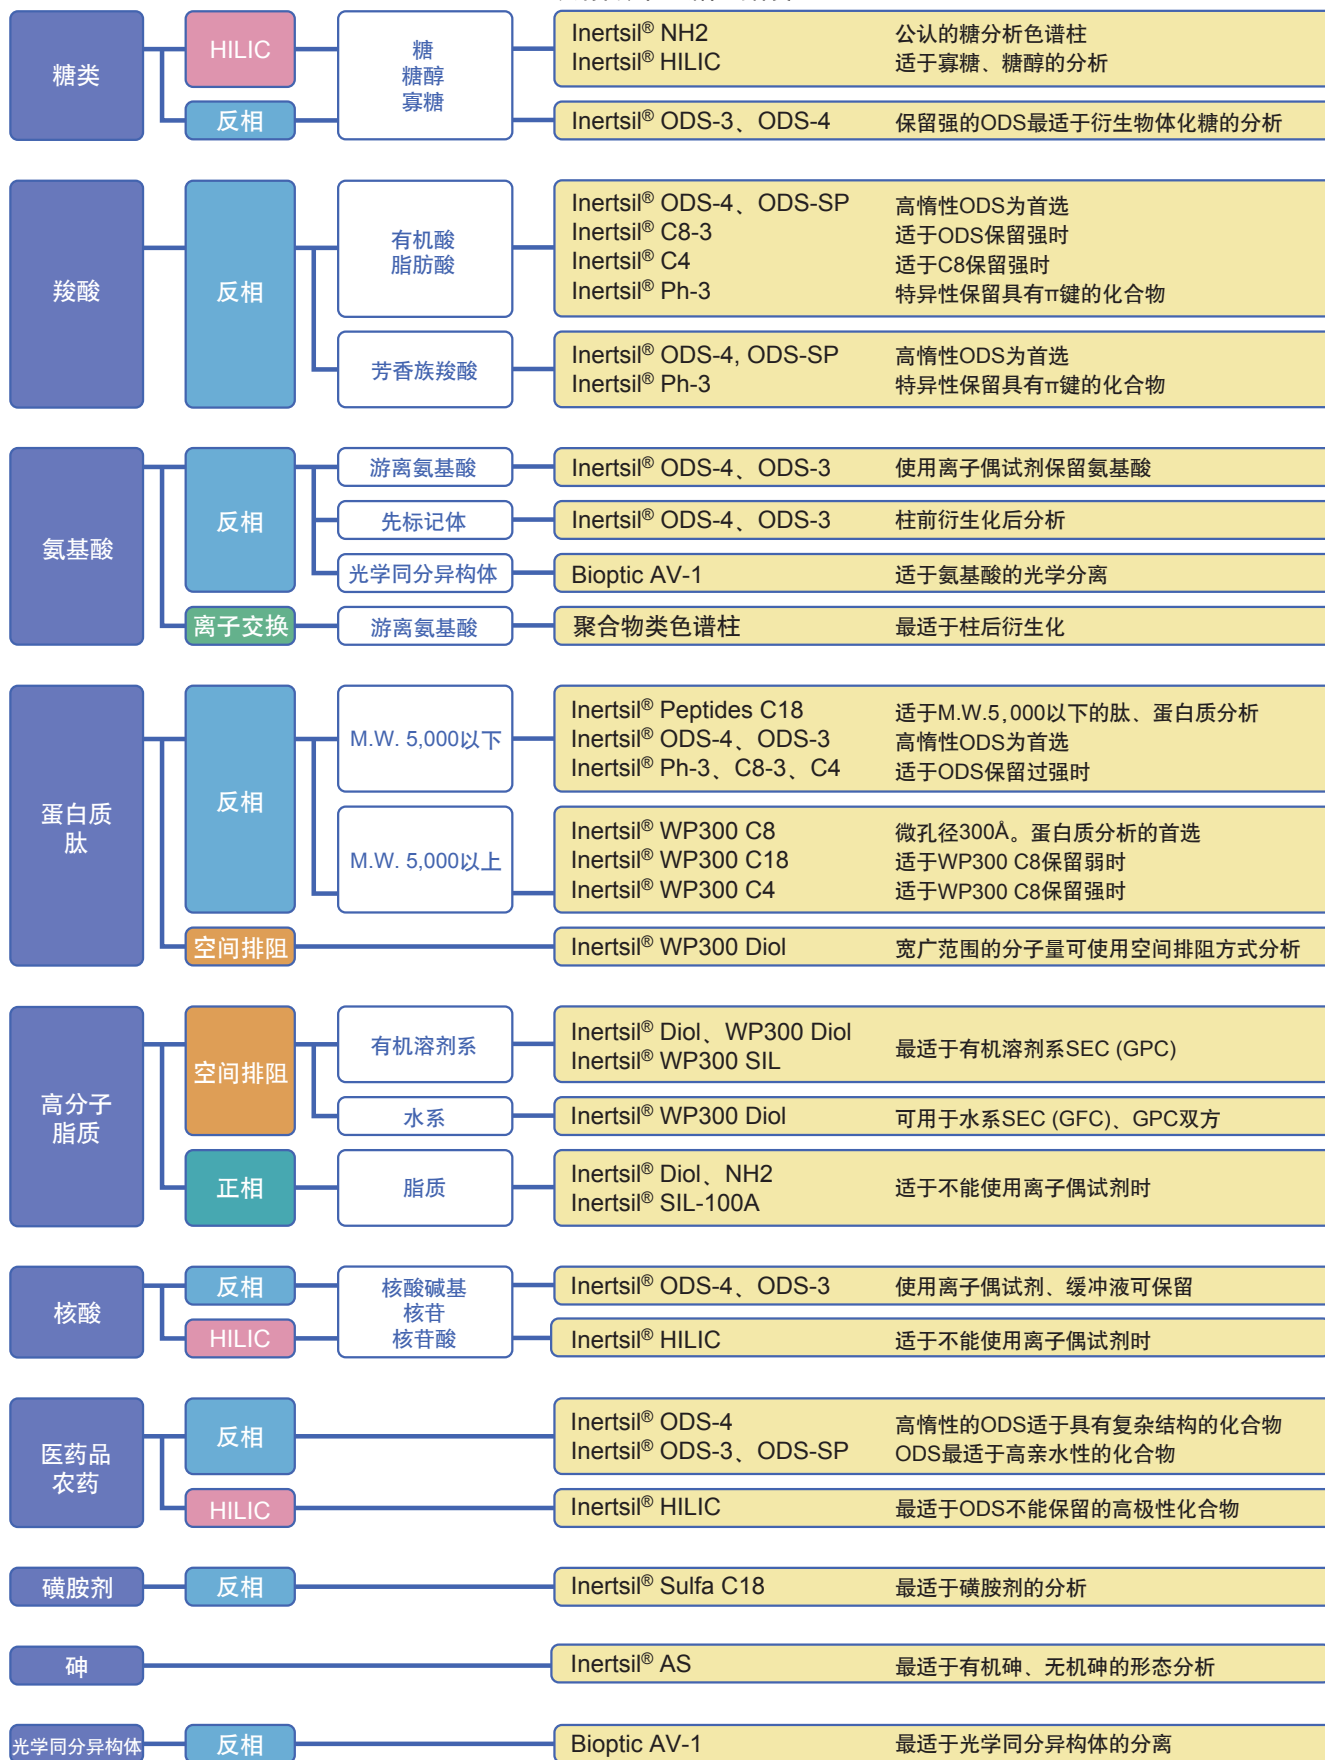

固相萃取·前处理附件

通用色谱消耗品

液相色谱消耗品及相关装置

气相色谱消耗品及相关装置

光谱

其他